

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

下記 2 項目の検査試薬につきまして、試薬販売元から、従来試薬を販売中止し、特異性の向上した改良試薬に移行する旨の連絡がございました。

これに伴い弊社では下記日程で改良試薬による検査に変更させていただきますので、取り急ぎご案内申し上げます。

先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、事情をご賢察の上、何卒宜しくご了承の程お願い申し上げます。

謹白



項目名


- 麻疹-IgM抗体／EIA法 (依頼コード No.5044、7687)
- 単純ヘルペス (HSV)-IgM抗体／EIA法 (依頼コード No.5032、7667)

変更日 2013年12月2日(月)受付分より

裏面に続きます

● 麻疹-IgM抗体／EIA法

測定試薬を特異性が向上した改良試薬に変更させていただきます。
この試薬変更に伴う検査要領等の変更はございません。

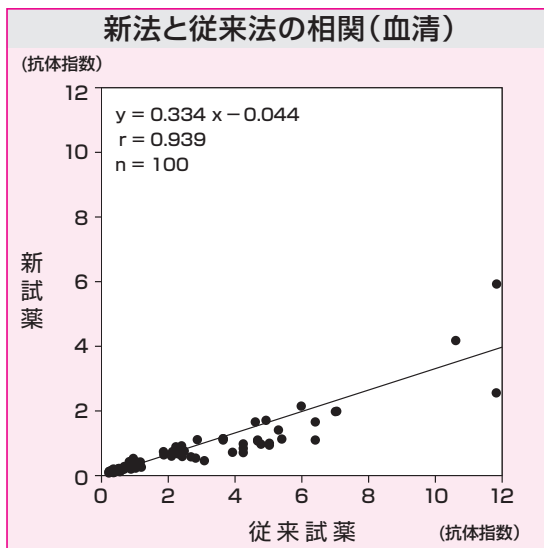

		従来試薬			合計
		+	±	-	
新試薬	+	13	0	0	13
	±	15	0	0	15
	-	12	30	30	72
合計		40	30	30	100

陽性一致率 32.5%
陰性一致率 100.0%
判定一致率 43.0%


自社検討資料

判定基準

(+) : 1.21 以上
(±) : 0.80 ~ 1.20
(-) : 0.80 未満

● 単純ヘルペス(HSV)-IgM抗体／EIA法

測定試薬を特異性が向上した改良試薬に変更させていただきます。
この試薬変更に伴う検査要領等の変更はございません。

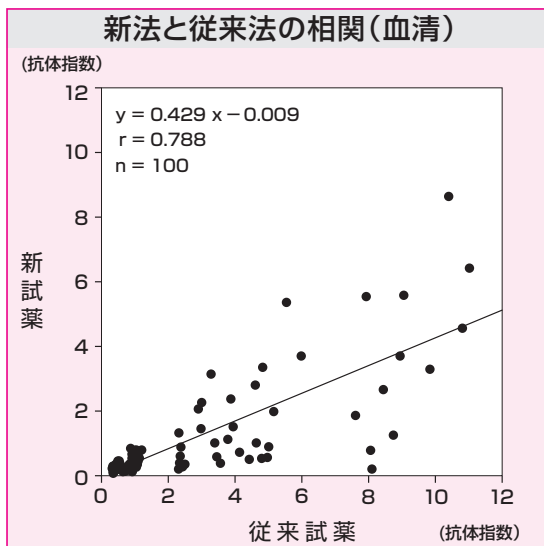

		従来試薬			合計
		+	±	-	
新試薬	+	22	0	0	22
	±	6	4	0	10
	-	12	26	30	68
合計		40	30	30	100

陽性一致率 55.0%
陰性一致率 100.0%
判定一致率 56.0%

自社検討資料

判定基準

(+) : 1.21 以上
(±) : 0.80 ~ 1.20
(-) : 0.80 未満

【参考文献】

麻疹-IgM抗体

庵原俊昭, 他: 医学と薬学 69(6), 969-975, 2013.

単純ヘルペス(HSV)-IgM抗体

川名 尚, 他: 医学と薬学 69(3), 517-522, 2013.