

CD45 Blast Gating法による急性白血病解析セット 検査結果報告書レイアウト一部変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

下記の検査につきまして、この度、現測定機器の保守サービスが終了したため、同一製造販売元の後継機に更新させていただきます。

それに伴い解析ソフトウェアが変更となるため、検査結果報告書のレイアウトを別掲のように一部変更させていただきます。

先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

謹白



対象報告書

総合検査案内 2022 : 116 ページ掲載

● CD45 Blast Gating法による急性白血病解析セット 検査結果報告書

変更日 2023年1月5日(木) ご依頼分より

変更内容

- 検査結果報告書下部の各マーカー陽性率を「表形式+Gate Aグラフ」から「Gate A/B/Cグラフ」へ変更します。

裏面に続きます

株式会社 **ビー・エム・エル**

本社 : 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-3

総合研究所 : 〒350-1101 埼玉県川越市的場1361-1

☎ 03(6629)7386 FAX 049(232)3132

検査項目検索用
アプリ B-Book




電子カルテはビー・エム・エル




検査結果報告書見本(解析チャート部分を抜粋)

従来

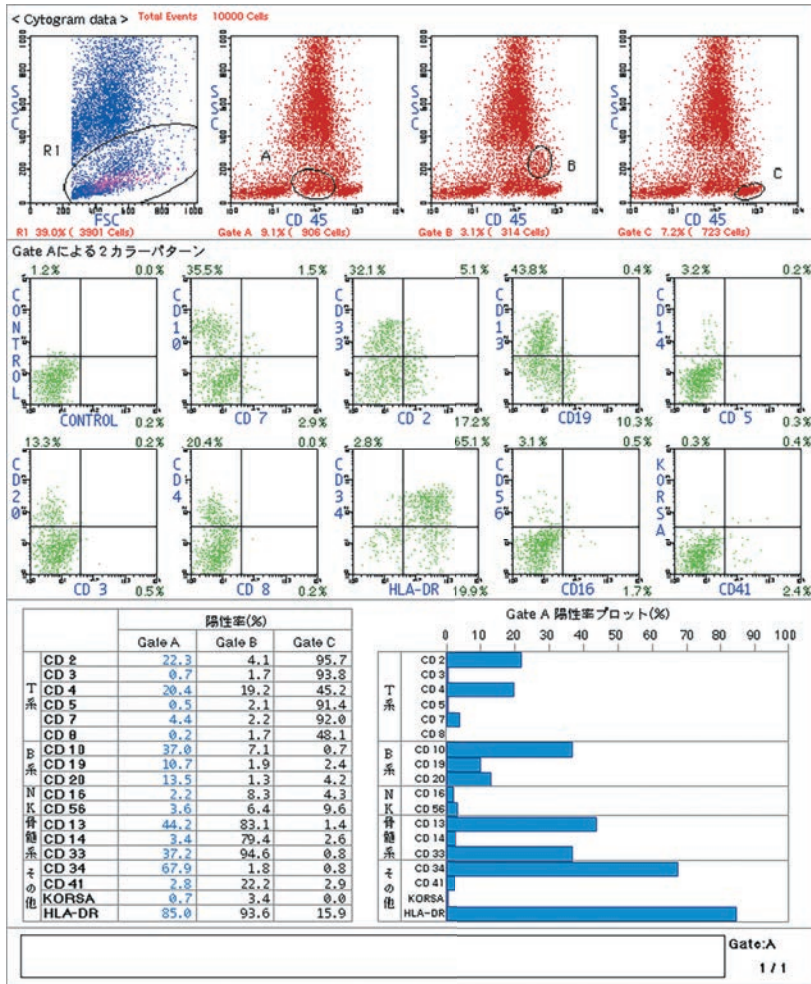

新

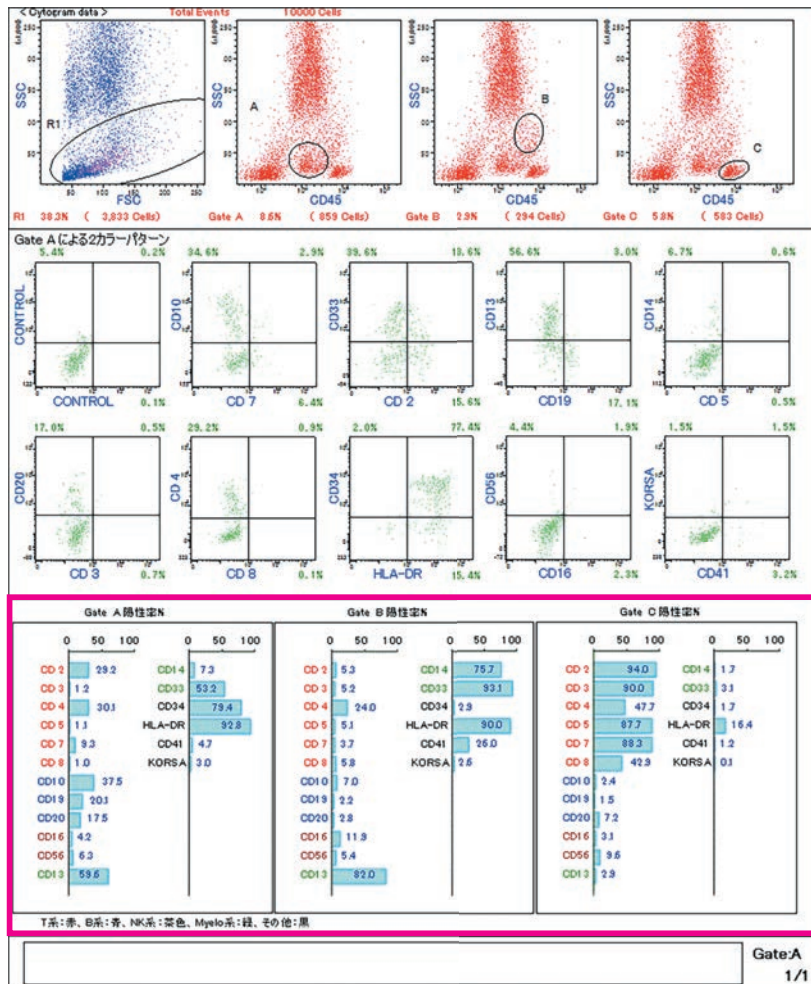

← [変更箇所]
Gate A/B/Cの陽性率を
グラフで表示します